

FICHA EQUIPO CLÍNICO




BAÑO MARÍA PARA MAMADERAS (BIBERONES)

Modelo: BMM140E0


Construcción completa de Acero Inoxidable. Módulo Bano María, eléctrico.
Criba perforada. Frente, posterior y costados cerrados.
Calefactores Blindados de Inmersión.
Temperatura controlada por termostato.
Patas de acero inoxidable, terminadas en niveladores.

Capacidad para 7 Canastillos de 12 mamaderas c/u. total 84 mamaderas.


Vista Frontal

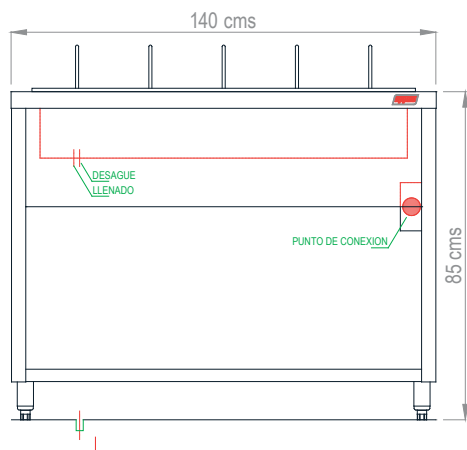

Vista Lateral

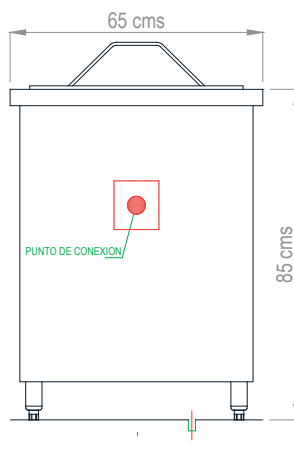

Vista Planta

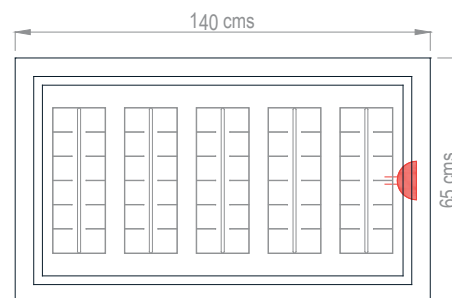

Consumos

- Potencia: 4.800 W
- Voltaje: 220 V / 380 V
- Amperaje: 22 / 11 Amp
- Dimensiones: 140 x 65 x 85 cm.

Requerimientos

- Enchufe Hembra 32 Amp. (Monofasico)
- Altura enchufe posicionado: 55 cm
- Desagüe 32 mm a piso.
- Conexión desagüe: 1/2"
- Conexión agua (Opcional): 1/2"

Nomenclatura

Eléctrico:

- Punto de conexion
- ☑ Enchufe a muro

Sanitario:

- Desague, Según Indicaciones

Mantenciones Mínimas

- Al final del día, después de usado el equipo, limpie todas las superficies en contacto con los alimentos para así mantener las condiciones sanitarias.
- Después de la instalación no es necesario realizar ningún ajuste por parte del usuario. Si se requiere de un servicio, solo personal autorizado por OPPICI S.A. deberá realizarlo.
- Si se produce cualquier anomalía en el equipo, que usted no pueda solucionar, comuníquese con nuestro servicio técnico, el cual estará atento a solucionar sus problemas al respecto (+562 2923 2029).



Calidad Inoxidable, comprometidos con la salud de Chile.



Av. El Montijo Poniente 1132, Renca. Santiago. ☎ +56 2 2923 2000 🌐 oppici.com

Sector Público : ventasclinicas@oppici.cl

Sector Privado : ventasclinicas4@oppici.cl